

FICHE DE SYNTHÈSE DU MASQUE :

**Breeze Nasal +
Nasal à fuite**

Fabricant : SEFAM
Distributeur : SEFAM




ESSAIS RÉALISÉS EN : novembre 2014

CENTRE D'ÉVALUATION : AGEVIE - Assistance du Grand Est - Nancy
(Patrick ULME)


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Poids du masque (gr) : **65**
- Poids du harnais (gr) : **28**
- Espace mort minimum* (cm³) : **92** (mesuré sur une tête d'essais)
- Espace mort maximum* (cm³) : **112** (capacité totale du masque)
- * valeur à +/- 5 cm³ (modèle L)

Breeze Nasal

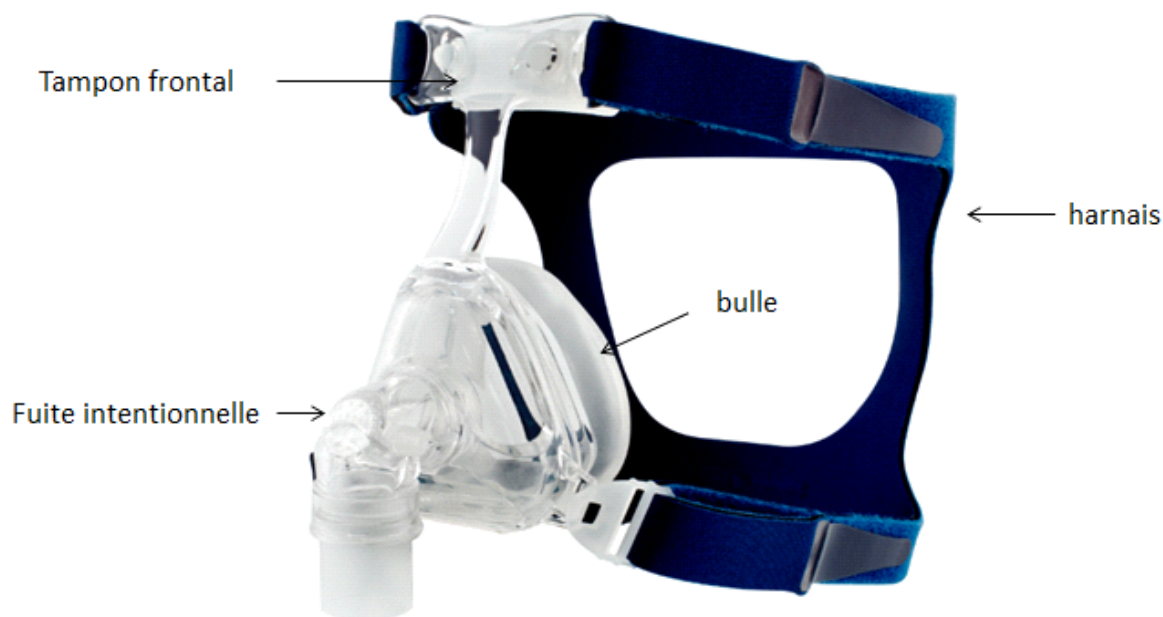

EVALUATION TECHNIQUE

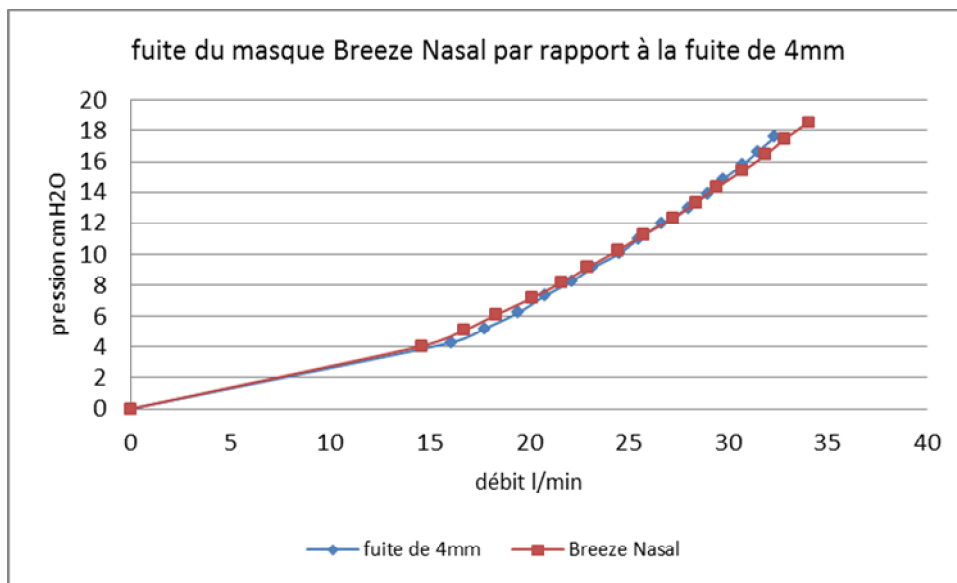

Remarque: le masque a été testé complètement monté. Impossible de dissocier la fuite du masque.

APPRECIATION – OBSERVATION

La courbe pression / débit est « dans la norme ». Dans cette nouvelle gamme Breeze, ce masque nasal + est de conception classique. L'armature du masque est plutôt légère et la bulle en silicone - assez profonde - s'y place simplement. A noter une cale frontale (trois tailles différentes interchangeables) et un coude rotatif à 360° qui facilite les mouvements du patient pendant la nuit. Le harnais manque d'élasticité : son réglage s'ajuste par un système de velcros et se fixe rapidement au masque par crochets. La fuite est assez silencieuse et légèrement diffuse.

RAPPEL DES PRINCIPES DU PROTOCOLE D'EVALUATION TECHNIQUE (version du 02/11/2004)

Matériel de mesures : VENTEST

Accessoire(s) : fuite de 4 mm de diamètre

Principes : La courbe pression / débit du masque étudié est comparée à une courbe pression / débit de référence. Cette courbe pression / débit de référence est réalisée en utilisant une fuite non linéaire caractérisée par un orifice de 4 mm de diamètre (débit de fuite suffisant pour garantir un rinçage du CO2 satisfaisant). Tous les tracés, après avoir été reproduits au moins deux fois, seront datés et associés à la courbe de référence du jour des essais. Toute courbe superposable ou située à droite de la courbe de référence (pour une pression donnée, le débit de fuite du masque étudié est supérieur ou égal au débit de l'orifice de 4 mm) signifie que le masque évalué se classe « dans la norme », toute courbe située à gauche de la courbe de référence signifie que le masque se classe « hors norme » ou « à utiliser avec certaines précautions (à préciser).

La valeur de l'espace mort correspond :

- Pour l'espace mort mini : à la quantité d'eau contenue dans le masque jusqu'au dispositif de fuite intentionnelle lorsque celui-ci est positionné sur la tête d'un mannequin.
- Pour l'espace mort maxi : à la quantité d'eau contenue dans le masque jusqu'au dispositif de fuite intentionnelle.

Les mesures sont réalisées au moins 3 fois et doivent être équivalentes pour la prise en compte de la valeur.

« Ce document est la propriété intellectuelle de l'Antadir qui en est l'auteur : toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement préalable de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (Article L122-4 du Code de la Propriété intellectuelle).